eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



URZĄDZENIE DO LIFTINGU ULTRADŹWIĘKOWEGO HIFU BEIJING SUPERLASER SL-FUV501

Zamawiający wycenę:	**Erste Leasing Sp. z o.o.** **ul. Kolorowa 8, Poznań**
Numer zlecenia:	87/06/08/2026/Erste Leasing ECR
Numer wewnętrzny:	NP6/01279/2025
Nr fabryczny:	250210041-2
Autor wyceny:	Przemysław Kalużny

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Erste Leasing.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 10.08.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu depozytowego zleceniodawcy w Tarczynie przez rzeczoznawcę: Sebastian Konopik.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie kosmetologiczne HIFU SUPERLASER SL-FUV501, przeznaczone do nieinwazyjnych zabiegów liftingujących, ujędrniających oraz poprawiających wygląd skóry. Urządzenie wykorzystuje technologię skoncentrowanych ultradźwięków o wysokiej intensywności (HIFU – High Intensity Focused Ultrasound), umożliwiając precyzyjne oddziaływanie na wybrane warstwy tkanek. Zabiegi wykonywane przy jego użyciu mają na celu m.in. poprawę napięcia i elastyczności skóry, redukcję zmarszczek, modelowanie owalu twarzy oraz stymulację procesów regeneracyjnych i produkcji kolagenu.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Urządzenie do liftingu ultradźwiękowego
Producent:	BEIJING SUPERLASER TECHNOLOGY CO.,
Typ/model:	SL-FUV501
Numer fabryczny:	250210041-2
Czas pracy:	Brak danych
Rok produkcji:	2025

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Moc:	250W
Zasilanie:	230V
Wyświetlacz:	15", dotykowy
Wyposażenie:	5 x głowica zabiegowa Przewód zasilający Akcesoria zabiegowe

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Podczas oględzin urządzenie znajdowało się w hali magazynowej, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Urządzenie podłączono do źródła zasilania i uruchomiono. Z uwagi na brak wykwalifikowanego

operatora nie przeprowadzono próby funkcjonalnej ani zabiegu testowego. Nie dokonano również weryfikacji poprawności działania poszczególnych głowic oraz elementów wyposażenia. Urządzenie nie reaguje na dotyk ekranu. Ze względu na ograniczony zakres próby należy uwzględnić możliwość ujawnienia dodatkowych usterek, niesprawności poszczególnych podzespołów lub ewentualnych braków w kompletacji podczas dalszego użytkowania. Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Stan wizualny urządzenia oceniono jako dobry.

Dane identyfikacyjne i techniczne przyjęto na podstawie tabliczki znamionowej oraz materiałów producenta dostępnych na jego stronie internetowej. Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE
Nie przedstawiono dokumentacji technicznej ani informacji dotyczących terminu ostatniego przeglądu lub czynności serwisowych.

CE:
Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.


ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

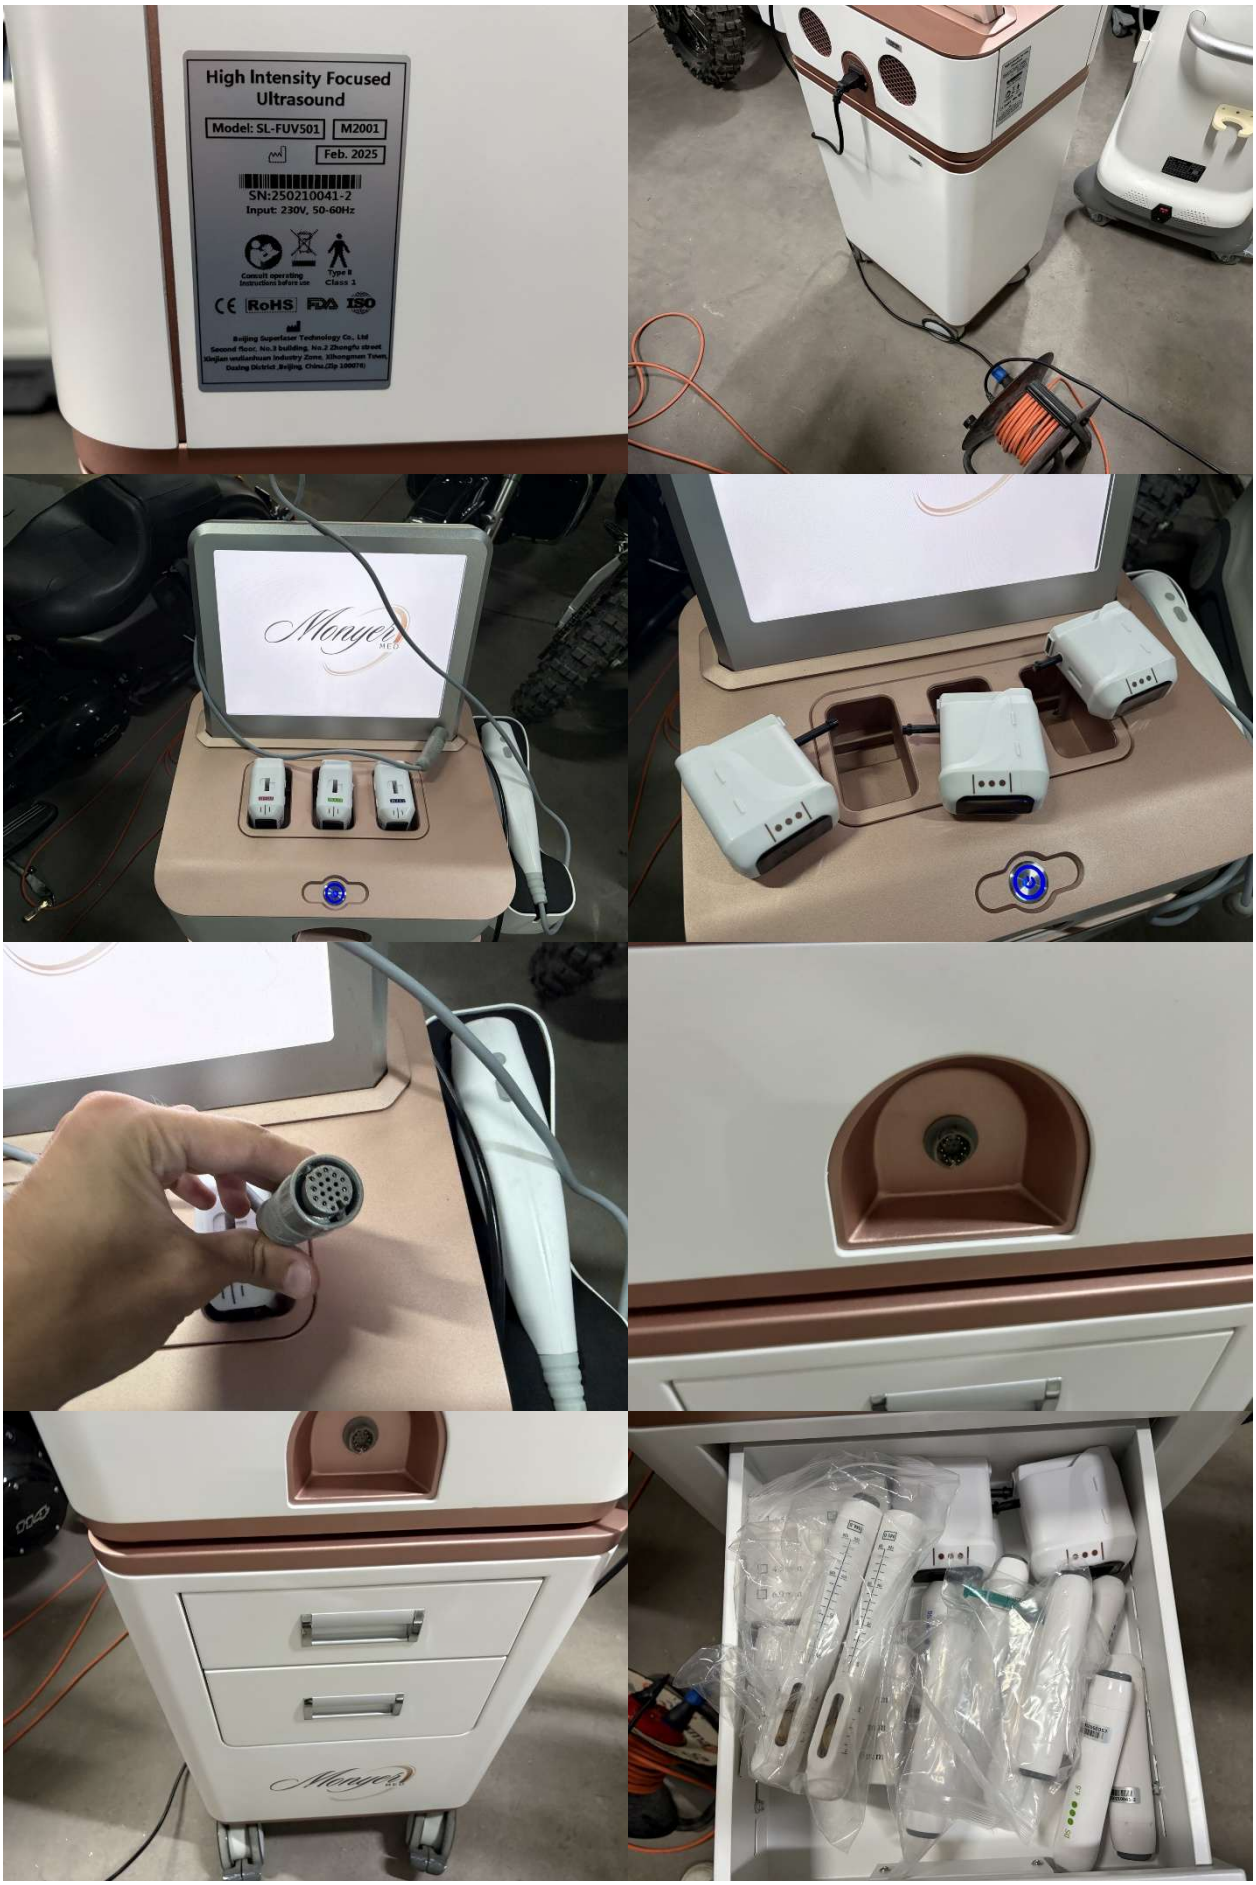


High Intensity Focused Ultrasound
Model: SL-FUV501
M2001
Feb. 2025
SN:250210041-2
Input: 230V, 50-60Hz
RoHS
FDA
ISO




Monyer
MED